


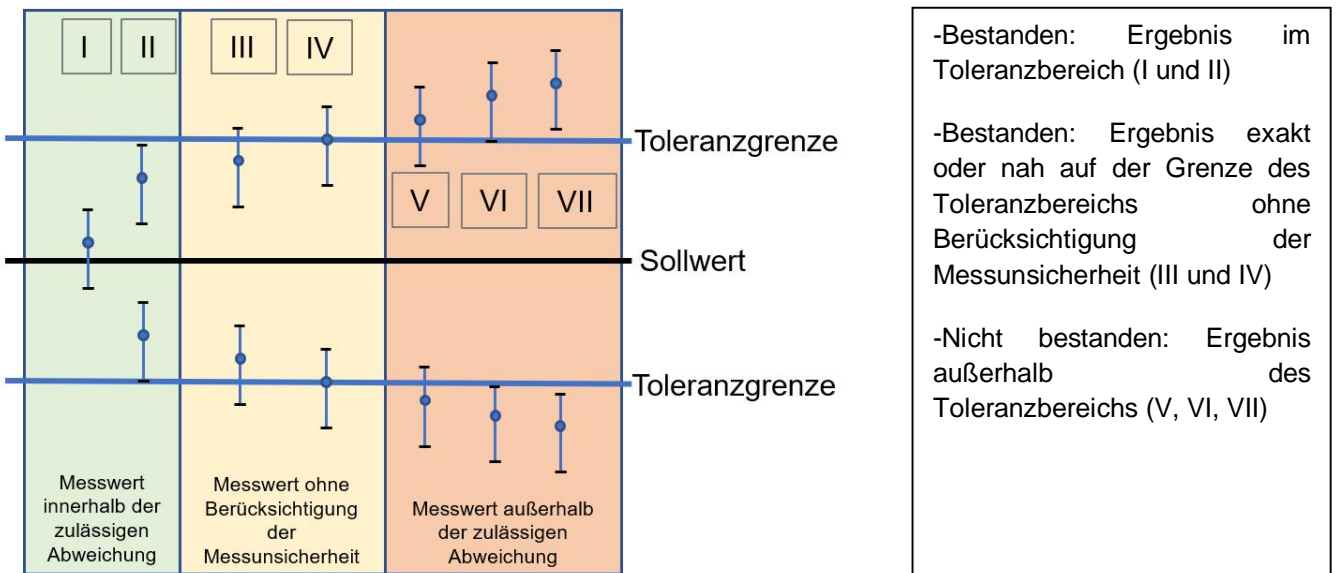
Version:	1.2	Datum:	10.01.2025
Kapitel:	7.8.4	Seite:	1 von 1
Kapitelinhalt:		<b>Konformität von Prüfergebnissen</b>	

Diese Konformitätsaussage gilt in Ergänzung zu den AGB Absatz 3 bzw. zum Kundenauftrag. Gemäß der Norm DIN EN ISO/IEC 17025: 2018, Kapitel 7.8.3.1 und 7.8.6 besteht die Anforderung eine Aussage zur Konformität von Prüfergebnissen mit dem Kunden zu vereinbaren. Dabei muss die angewandte Entscheidungsregel dokumentiert werden.

In der NonaChem GmbH werden die im folgenden dargestellten Entscheidungsregeln angewendet:

1. Sofern die Entscheidungsregel in Normen oder Spezifikationen der beauftragten Prüfungen festgelegt ist, gelten diese als mit dem Kunden vereinbart.
2. Sofern der Kunde eine andere Entscheidungsregel bzw. eine eigene Anforderung an das Prüfergebnis benötigt, muss er diese separat schriftlich mit der Auftragsanfrage/dem Auftrag mitteilen und den entsprechenden Entscheidungsfall (Nr. I - VII) gemäß dieses Dokuments angeben.
3. Sofern die oben genannten Punkte 1. und 2. nicht vorliegen, wird grundsätzlich folgende Entscheidungsregel angewandt:

Messunsicherheit (+)		Der Wert der Messgröße liegt mit einer 95%igen Wahrscheinlichkeit im zugeordneten Werteintervall (gem. DAkkS-DKD-5).	Der Abstand zwischen blauem Punkt und jeweils schwarzer Linie ist die erweiterte Messunsicherheit.
Ist-Wert			
Messunsicherheit (-)			



Bei der Konformitätsaussage werden keine Messunsicherheiten berücksichtigt.